

Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Piemonte
C.F. 07176380017

SEDUTA del 07/04/2022

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016,
PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 5 LOTTI DI STRUMENTAZIONE
TECNICO-SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE**

Verbale tecnico: LOTTO 1: n. 1 (uno) ICP MS (Spettrometro di massa a quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente)

Destinazione: Laboratorio di Alessandria

Il giorno 07 aprile 2022 alle ore 09:30 si è riunita in web call la Commissione giudicatrice composta dai seguenti membri:

Presidente: Dott.ssa Laura Erbetta
Commissaria: Dott.ssa Marilisa Gaino
Commissaria: Sig.ra Valeria Zulian
Segretaria: Dott.ssa Roberta Pasin

per la verifica delle offerte tecniche presentate delle seguenti ditte:

- Thermo Fisher Scientific SpA;
- Perkin Elmer Italia SpA;

per l'affidamento della **fornitura di n.1 ICP MS Spettrometro di massa a quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente.**

Nella seduta del 01/04/2022 si era proceduto con la lettura delle offerte tecniche e con una prima disamina del rispetto dei requisiti minimi irrinunciabili previsti dal Capitolato di gara. Nella seduta odierna si è proseguito con la valutazione delle offerte e dei requisiti per entrambe le ditte in gara.

A conclusione dei lavori, la Commissione **dichiara l'esclusione della ditta Thermo Fisher Scientific SpA dal prosieguo della procedura di gara, data l'impossibilità di attivare qualsivoglia soccorso istruttorio in merito ai contenuti dell'offerta tecnica, per le motivazioni di seguito indicate.**

L'offerta tecnica presentata dalla ditta Thermo Fisher Scientific SpA e la documentazione tecnica a corredo non comprendono alcuni requisiti minimi irrinunciabili indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto (rif.to Lotto 1 - pagg. 5-7 del Capitolato).

In particolare, si rileva che la ditta non ha fornito le seguenti informazioni richieste nel Capitolato:

- Con riferimento al **punto 6.4** (rif.to Lotto 1 - pag. 5 del Capitolato) "*Prestazioni analitiche: Il limite di rilevabilità del metodo, calcolato come MDL secondo metodo EPA 200.8 1994; per ogni elemento di tabella 1 deve risultare inferiore o uguale a quanto riportato nelle colonne A e B*", **la ditta non ha fornito evidenza del rispetto dei requisiti richiesti per le condizioni analitiche indicate in colonna A di Tabella 1 (Limiti rilevabilità MDL in µg/L Acqua pura con ac.nitrico circa 6-7% + HCl circa 2%)**

- Con riferimento al **punto 6.5** (rif.to Lotto 1 - pag. 5 del Capitolato) "*Prestazioni su soluzioni fortificate con CRM: 6 repliche a tre livelli nel campo di prova per ciascuna soluzione acida per un totale di sei set di repliche*" **la ditta non ha fornito i dati relativi alle prestazioni su soluzioni fortificate con CRM nelle concentrazioni pari a:**
2 x MDL colonna A della tabella 1 con soluzione acida colonna A
10 x MDL colonna A della tabella 1 con soluzione acida colonna A.
- Con riferimento al **punto 7.9** (rif.to Lotto 1 - pag. 6 del Capitolato) "*Software e Stazione di lavoro per il controllo di tutte le funzionalità dello strumento: La stazione di lavoro deve avere una scheda di rete dedicata per la connessione alla rete aziendale*", **la ditta non menziona la presenza di una scheda di rete dedicata per la connessione alla rete aziendale**

Riguardo alla ditta **Perkin Elmer Italia SpA**, dall'esame dell'offerta tecnica presentata e della documentazione tecnica a corredo, appare necessario richiedere ulteriori precisazioni in merito ai seguenti punti (requisiti di base riportati all'art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto):

- lingua nella quale sono redatti i manuali d'uso hardware e software in quanto nella relazione tecnica si fa riferimento a manuali d'uso hardware e software senza specificare se sono redatti in lingua italiana o altra lingua.
- conferma della presenza di licenza d'uso del software dello strumento in quanto nella relazione tecnica non appare chiaro se il software ne sia provvisto.

Si sospende pertanto la valutazione dell'offerta tecnica della ditta **Perkin Elmer Italia SpA**.
Con nota pec a firma del Responsabile della Struttura semplice Acquisti beni e servizi, verranno posti al suddetto operatore economico i chiarimenti necessari.


La seduta è chiusa alle ore 11:10

Letto, confermato e sottoscritto


Laura Erbetta (Presidente)

Firmato digitalmente da: LAURA ERBETTA
Data: 12/04/2022 15:59:28

Marilisa Gaino (Commissaria)



Valeria Zulian (Commissaria)

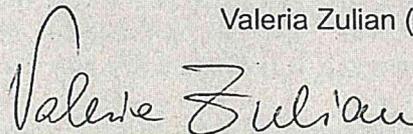

Roberta Pasin (Segretaria Verbalizzante)

